

Giunzione KF Vacuum



Come innestare il PressurDisk agli impianti usando una giunzione KF Vacuum

Hai bisogno di misurare la pressione nel vuoto in una tubatura? Ora puoi collegare il PressureDisk di Tecnosoft direttamente all'impianto usando una giunzione KF Vacuum.

Posizionare un PressureDisk / PressureDisk 05 sulla congiunzione KF Vacuum

Step 1

Prendi la parte della tubatura filettata con la flangia.




Step 2

Avvita il pezzo di tubatura sull'estremità filettata del logger.




Step 3

Collega la flangia del logger con quella della tubatura posizionando una guarnizione tra loro. Assicurati che la guarnizione sia posizionata correttamente nelle rientranze delle flange.

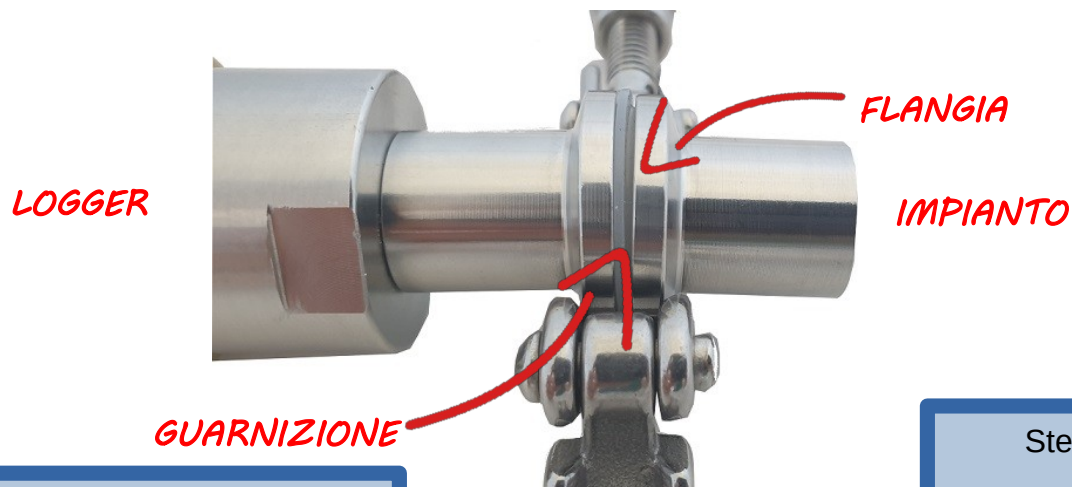

Step 4

Chiudi la giunzione KF Vacuum.

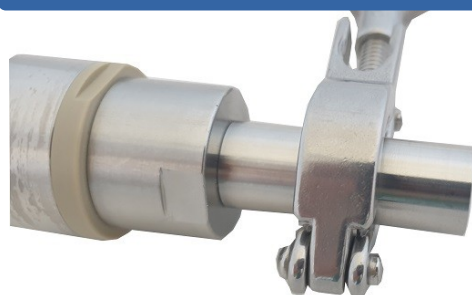

Step 5

Avvita la giunzione saldamente.

